ロンシー ショルダーサスペンションシステム
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品の二次的加工をしないでください。
3) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力がかからないように装着してください。
4) 機器に重大な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性があるため、当社指定の構成品以外の組合せで使用しないでください。
5) 本品に熟練した人以外は使用しないでください。
6) ショルダーサスペンショントラップ（別売品）は再滅菌・再使用しないでください。
7) ショルダーサスペンショントラップ(別売品)の包装に損傷のある場合は使用しないでください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

【ロンシーショルダーサスペンションシステム】

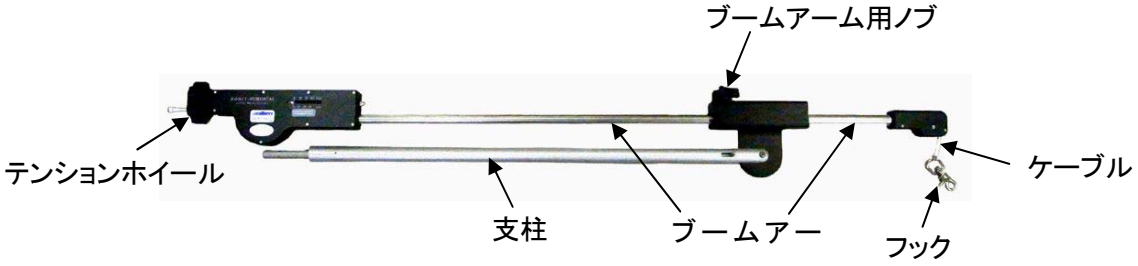

【ショルダーサスペンショントラップ(別売品)】

トラップ材質:ポリエチレンテレフタレート

固定用バンデージ

金具付ロープ

3. 一般的な使用方法とその注意事項

1) 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭してください。
2) シンプルクランプ（別売品）を斜めに傾けながら手術台のサイドレールに取り付け、固定用ノブを締めます。

3) シンプルクランプのパワーグリップをゆるめて、本システムの支柱を差し込みます。

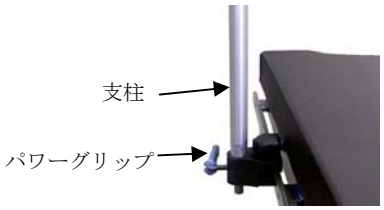

> ⚠ 注意
> ブームアームの位置が調節されるまでパワーグリップは締めないでください。

4) ショルダーサスペンショントラップ(別売品)に患者の腕を入れます。この時、指がゆったりできる状態を確保してください。
5) ショルダーサスペンショントラップの上から固定用バンデージを手首又は前腕に巻きつけて固定します。
その際、固定用バンデージの端から約 15cm の余裕を残し、この部分を伸ばして巻きつけるとよりしっかりと固定できます。

> ⚠ 注意
> - 固定用バンデージは､強く巻きすぎないようにしてください。血流を阻害するおそれがあります。
> - ショルダーサスペンショントラップのループ部分を軽く引っ張り､ショルダーサスペンショントラップが腕から抜けないことを確認してください。

6) ショルダーサスペンショントラップのループ部分を本システムのケーブル先のフックに取り付けます。
7) 患者の腕を適切に保持できるように、本システムの向き・角度・ブームアーム長・ケーブル長等を調節します。
   ① 本システムの支柱を旋回させてブームアームの向きを調節し、シンプルクランプのパワーグリップを締めます。
   ② ピンを引き下げながらブームアームの角度を調節し、ピンをはなして固定します。
   ③ ブームアーム用ノブをゆるめてブームアームの長さを調節し、ブームアーム用ノブを締めます。
   ④ テンションホイールでケーブルの長さを調節してください。テンションホイールを時計回りに回すとケーブルが短くなり、反時計回りに回すとケーブルが長くなります。

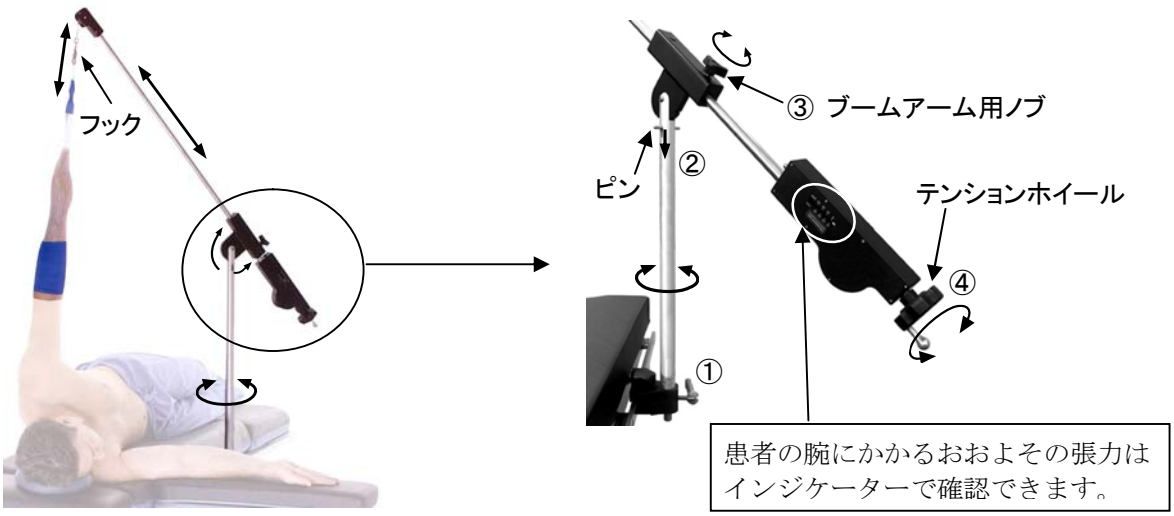

4. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒してください。

5. 保守点検に関する事項

1) 点検
   破損・変形・可動部の動き等を点検してください。
2) 耐用期間［自己認証（当社データ）による］
   ロンシーショルダーサスペンションシステム：5年
   ショルダーサスペントラップ：滅菌有効期限を外箱に表示

6. 技術仕様

1) ブームアーム角度の可動範囲：0～90°
2) 張力：0～18.2kg

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品　番	商品名
623-005-04	R-644-36-A1	ｼｮﾙﾀﾞｰ ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ
623-400-18	A-40018	ｼﾝﾌﾟﾙｸﾗﾝﾌﾟ
623-212-00	A-21200-A1	ｼｮﾙﾀﾞｰｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾄﾗｯﾌﾟ　(6本入)

8. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*ロンシー ショルダーサスペンションシステム* をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.
※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: *ロンシー ショルダーサスペンションシステム* ご芳名 ご住所 TEL.　　(　　)	お買い上げ店名 印 住所 TEL.　　(　　) お買い上げ日　　年　　月　　日

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546